

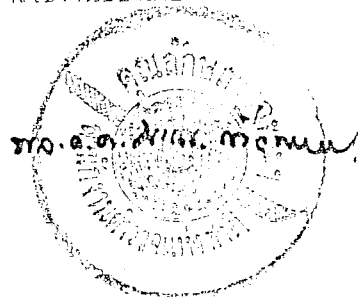
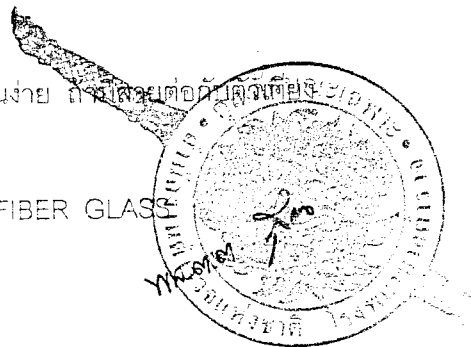
เตียงผ่าตัดทั่วไป

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับใช้ในการผ่าตัดทั่วไป และสามารถจัดท่าในการผ่าตัดได้อย่างสะดวกทุกๆ ท่า

2. ลักษณะทั่วไป

- 2.1 เป็นเตียงผ่าตัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL)
- 2.2 เครื่องควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL) มีขนาดเล็กใช้งานง่าย ง่ายต่อการใช้งาน และต้องสามารถถอดออกได้
- 2.3 ฐานเตียงเป็นรูปตัว T ห่อหุ้มด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมหรือทำด้วยวัสดุ FIBER GLASS
- 2.4 เคลื่อนย้ายเตียงได้โดยมีล้อหมุน พร้อมมีระบบห้ามล้อ
- 2.5 พื้นเตียงและเบาะทำด้วยวัสดุที่แสง X-RAY ฉายผ่านได้
- 2.6 ใต้พื้นเตียงมีที่สำหรับสอดถาดใส่ฟิล์ม X-RAY ใช้ได้ตั้งแต่หัวไหล่ ถึงบริเวณเชิงกราน
- 2.7 ข้างเตียงทั้งสองข้างมีราวเหล็กกล้าไร้สนิม สำหรับเป็นที่ยึดจับอุปกรณ์ประกอบการใช้งานของเตียง
- 2.8 ขนาดของเตียง
 - 2.8.1 ขนาดของเตียงรวมส่วนรองรับศีรษะ ยาวไม่น้อยกว่า 190 เซนติเมตร
 - 2.8.2 ขนาดของเตียงกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
- 2.9 สามารถใช้กับเครื่อง X-RAY C-ARM ได้
- 2.10 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์



3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ


- 3.1 มีแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อนการทำงานของเตียง ซึ่งสามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ใหม่เมื่อใช้ไฟหมด
- 3.2 เครื่องควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL) มีสัญญาณบอกให้ทราบว่าแบตเตอรี่มีไฟพอเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่
- 3.3 การปรับท่าของเตียงโดยการใช้เครื่องควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL) มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.3.1 พื้นเตียงแยกได้ไม่น้อยกว่า 4 ส่วน
 - 3.3.2 เียงซ้ายขวา ได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา


พ.ล.ต.ศ.		ประธานคณะกรรมการ	พ.ล.ต.ต.หญิง		กรรมการ
พ.ล.ต.ศ.		กรรมการฯ	พ.ต.อ.		กรรมการฯ
พ.ต.อ.		กรรมการฯ	พ.ต.อ.	ลาป่วย	กรรมการฯ
พ.ต.อ.หญิง		กรรมการฯ	พ.ต.ท.หญิง		กรรมการฯ
พ.ต.ท.หญิง		กรรมการฯ	พ.ต.ท.หญิง		กรรมการและเลขานุการ
พ.ต.ท.		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ			


พร. อิงเก็ ลงวันที่ 18 เม.ย. 2545


- 3.3.3 ปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า (ไม่รวมความหนาของเบาะ) 105 เซนติเมตร
- 3.3.4 ปรับระดับต่ำสุดได้ไม่เกิน (โดยวัดจากพื้นห้องถึงพื้นเตียงไม่รวมความหนาของเบาะ) 75 เซนติเมตร
- 3.3.5 ส่วนที่รองแผ่นหลังปรับลงได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา
- 3.3.6 ส่วนที่รองแผ่นหลังปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 55 องศา
- 3.3.7 ปรับทำศีรษะต่ำ TRENDELENBURG ได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา
- 3.3.8 ปรับทำเท้าต่ำ REVERSE TRENDELENBURG ได้ไม่น้อยกว่า 25 องศา
- 3.4 การปรับท่าของเตียง โดยการใช้เครื่องควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL) หรือด้วยมือ มีคุณสมบัติ ดังนี้
- 3.4.1 ส่วนรองขาปรับหรือพับลงได้ไม่น้อยกว่า 100 องศา
- 3.4.2 ส่วนรองขาปรับหรือพับหรือยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 15 องศา
4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
- 4.1 ที่รองรับแขนคนไข้พร้อมที่ยึดจับอุปกรณ์กับราวเตียง จำนวน 2 อัน
- 4.2 ฉากกันรังสีกัมมันตภาพรังสี จำนวน 1 อัน
- 4.3 ที่รัดข้อมือคนไข้ จำนวน 2 อัน
- 4.4 ที่รัดตัวคนไข้ จำนวน 1 อัน
- 4.5 ที่รองศีรษะคนไข้ จำนวน 1 อัน
- 4.6 ที่ยันหลังสี่ข้างและเอว จำนวน 2 อัน
- 4.7 ที่ยึดจับอุปกรณ์กับราวเตียง จำนวน 4 อัน
- 4.8 ที่รองรับขาแบบขาหยั่ง จำนวน 2 อัน
- 4.9 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม
5. การทดสอบและผล
- 5.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3, 4
- 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
6. ข้อกำหนดอื่นๆ
- ได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิต




พล.ต.ต.  ประธานคณะกรรมการ
(นกุล เจียมอนกุลกิจ)

รอง พตร. (สบ 8)
พล.ต.ต.  กรรมการฯ
(เยาวพันธ์ ยงพานิช)
นพ. (สบ 6) พต.


พล.ต.ต.หญิง  กรรมการฯ
(พจณี สุนทรเกตุ)
ผู้ช่วย พตร. (สบ 7)


พ.ต.อ.  กรรมการฯ
(พลวัต บุราวาศ)
ผกก.ยธ.สภบ. (ผู้แทน ผบก.ยธ.สภบ.)


ศร. อเนกต์ ลงวันที่ 18 มิ.ค. 2545


พ.ศ.อ.  กรรมการ
(อรรถพันธ์ พรหมฑารัตน์)
รอง ผบก.วพ.พต.


พ.ศ.อ. อจาปาย กรรมการ
(ประเสริฐ กิจเจริญวิศาล)
นพ.(สบ 5) รพ.พต.

พ.ศ.อ.หญิง  กรรมการ
(ประไพ ปิยะจันทร์)
หน.ฝ่าย (สบ 4) วร.วพ.พต.


พ.ศ.ท.หญิง  กรรมการ
(อุดม ชุ่มจินดา)
พยาบาล(สบ 3) รพ.พต.

พ.ศ.ท.หญิง  กรรมการ
(กรรณิกา ทิพย์คง)
พยาบาล (สบ 3) รพ.พต.

พ.ศ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ
(มาลินี ตริเนตร)
พยาบาล (สบ 3) รพ.พต.

พ.ศ.ท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ฉัตรพงศ์ เจริญทรัพย์)
รอง ผกก.กบ.บกก.อก.พต.


ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2545 เมื่อวันที่ 7 มิ.ค. 2545

พล.ต.ท. 
(นเรศ เทียนกริม)

ผบก. อก. สกบ. / กรรมการและเลขานุการ

แก้ไขคุณลักษณะเฉพาะโดยแก้ไขข้อ 2.3 ตัดคำว่า เช่นรูปตัว T ออก
ตามอนุมัติ พตร.(สบ 8) ลง 3 ม.ค. 2551 ภายหลังสืบก. อก.รพ.ท.ร. กวนที่สุคดี
0037.141/ 012 ลง 28 ธ.ค. 2550

ที่ประชุมคณะกรรมการที่พิจารณาคณะคุณลักษณะเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจ
ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

พล.ต.ท. 
(สุกิจ โคนินทรานกร)
ผบก. อก. รพ. ท.ร. / กรรมการและเลขานุการ